

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. "Dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego z wyposażeniem" ZP/45/ZCOSzpSp/2019

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytania do Załącznika nr 5 – Projekt umowy:

§8 ust. 2:


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,2% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia z dostarczeniem przedmiotu zamówienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w tym zakresie.

Pytania do Załącznika nr 6 – Stół operacyjny ortopedyczny wraz z wyposażeniem – 1 sztuka:

2. Czy w odniesieniu do punktu 4 tabeli, Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany stół operacyjny posiadał przystawkę ortopedyczną zamontowaną na stałe do blatu stołu? Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego określony jako „stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem”, zasadne jest aby taki stół posiadał przystawkę ortopedyczną zamontowaną na stałe, takie rozwiązanie stosowane jest przez topowych producentów stołów operacyjnych, zapewnia ono bardzo dobrą ergonomię pracy operatorów, swobodną dostępność aparatu RTG z ramieniem C oraz stabilność przy często bardzo inwazyjnych procedurach ortopedycznych (zdjęcie poglądowe stołu).

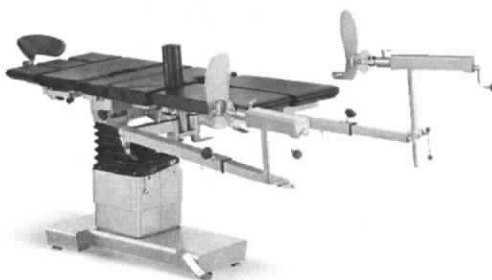

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby stół był wyposażony w przystawkę ortopedyczną na stałe.

Zamawiający modyfikuje poz. 4 tabeli „wymaganych parametrów i warunków” z zał. nr 6 do SIWZ następująco: Zmieniona zostaje treść zdania pierwszego, które obecnie brzmi:

„Przystawka ortopedyczna ze stali nierdzewnej, zamontowana stałe do blatu stołu operacyjnego.”

Proszę odpowiednio dokonać zmiany w treści zał. nr 6 do SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny, który posiada regulację wysokości blatu w zakresie 810 – 1210 mm?
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny, który posiada regulację oparcia pleców w zakresie od -20° do +80°?
5. Czy w doniesieniu do punktu 18 tabeli Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny, który posiada pilot przewodowy z możliwością sterowania następujących funkcji:
 - regulacja wysokości,
 - regulacja oparcia pleców,
 - przechyły boczne,
 - przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga,
 - funkcji flex/reflex,
 - pozycji „0” z jednego przycisku – poziomowanie blatu wraz ze wszystkimi segmentami regulowanymi poprzez napęd elektrohydrauliczny?
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny, który posiada na wyposażeniu wspornik kolana wyposażony w materac o wymiarach 25 x 190 x 295 mm? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe stołu oraz wspornika.
7. Czy Zamawiający stół operacyjny ortopedyczny, który posiada na wyposażeniu podpórkę do operacji ręki o wymiarach 40 x 400 x 800 mm z systemem mocującym do stołu? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe stołu oraz podpórki.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ortopedyczny, który nie posiada możliwości regulacji podnóżków?

Odpowiedź do pytań od 3 do 8:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanych w pytaniach rozwiązań. Wykonawca powinien wskazać zaoferowane parametry w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 9

Pytania do Załącznika nr 6 – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu oraz SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jaką minimalną wartość gwarancji Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, ponieważ w rozdziale XIV (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) jednym z kryteriów jest: **okres gwarancji (30%)**, w którym to minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, natomiast w załączniku nr 6 w tabelce technicznej warunki gwarancji stołu i systemu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta Zamawiający określił, iż okres gwarancji stołu i materaca nie może być krótszy niż 48 miesięcy? W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o podanie jaki ma być minimalny okres gwarancji na stół oraz materac.

Odpowiedź:

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 6 w tabelce „wymaganych parametrów i warunków” poz. 53:

Z: „Okres gwarancji stołu i materaca nie może być krótszy niż 48 miesięcy”

Na: „Okres gwarancji stołu i materaca nie może być krótszy niż 24 miesięcy”

Wykonawca powinien nanieść poprawkę w załączniku nr 6 do SIWZ.

Sporządził: Anna Wojtczyk


Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Katowicach
dr inż. Anna Wojtczyk