

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

„Dostawa wyrobów medycznych”

Dotyczy postępowania „Dostawa wyrobów medycznych”

Symbol sprawy: ZP/114/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1 –Dotyczy Pakietu 28 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji względem bakterii 99,9998%, skuteczność filtracji względem wirusów 99,999%, skuteczność filtracji względem NaCl $\geq 97,416\%$ wydajność nawilżania 33 mg/l przy VT 500ml, utrata wilgoci 6mg H₂O/litr przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 51ml, waga 28g, opór przepływu 1,2 cm H₂O przy 30 l/min, 2,7 cm H₂O przy 60 l/min, 4,8 cm H₂O przy 90 l/min, zakres objętości oddechowej 150-1200ml, port do kapnografii zakręcany koreczkiem, sterylny.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 17.poz.2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 17 poz. 2 „Jednorazowy zestaw przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz żylnego krwi DTXPlus z systemem pobierania krwi Safedraw” i utworzenie dla niej niezależnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 4

Mam pytanie czy nie zaistniała pomyłka w pakiecie nr 4 dotyczy drut do pętli migdałowych 10 m i średnicy 0,3mm w tabeli ilość wymagana jest jednostka 1000 to chyba jest za dużo. Pamiętam że Państwo zamawiacie pętle do urządzenia typ Brunings do wycinania polipów oraz migdałków dla dorosłych o ś. 0.3mm i opakowanie zawiera 100 szt.Poproszę o informację co dokładnie ma być w pakiecie nr 4.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza w pakiecie 4 - dł.10 cm. W załączeniu formularz asortymentowo – cenowy dot. tylko Pakietu nr 4 celem przedłożenia do oferty.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 25 poz. 4



Czy Zamawiający dopuści standardowe Cewniki Foleya bez możliwości pomiaru ciśnienia śródbrzusznego?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 25 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową skalowaną co 1ml do 40ml, co 5ml od 40ml do 100ml, co 10ml od 100ml do 500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 25 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści sondę dwunastniczą o długości 1250mm, wykonaną z medycznego PCV

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 25 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści sondy Zgłębniki żołądkowe silikonowe, przeciwoleżynowe, które zostały zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka. Zgłębniki te mogą być rekomendowane w szeregu przypadków:

dla pacjentów nie mogących odżywiać się lub połykać pokarmów;

dla pacjentów nie mogących wziąć do ust odpowiedniej ilości pokarmu;

dla pacjentów z wrodzonymi wadami twarzy, przełyku i żołądka.

Zalety:

wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;

odpowiednia miękkość i doskonała elastyczność zapewniają pacjentowi większy komfort;

zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie;


posiadają znacznik głębokości potwierdzający pozycję;

do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa;

sterylizowane, podwójne opakowanie;

długość 120cm

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

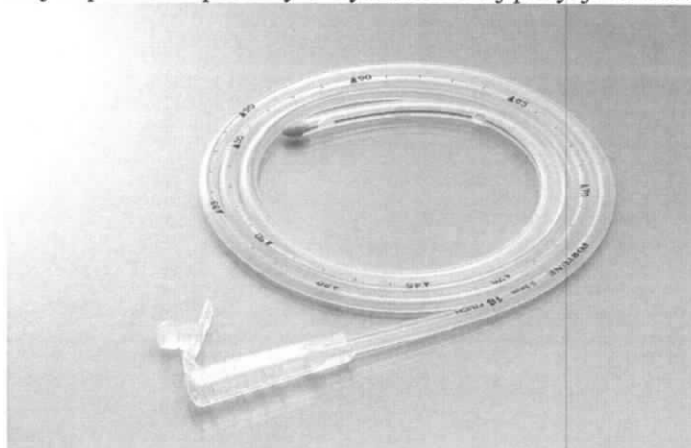

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu 25 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do lewatywy o poj. 1500ml z drenem łączącym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu 25 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewniki rektalne CH18-26 z zamkniętym końcem oraz dwoma otworami bocznymi długość 40cm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramion 18x45cm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny do jamy otrzewnej, dostępne m.in. w rozmiarach CH 24, 26, 27, 30 i 33?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu 27 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką z kontrolą ssania rozmiar CH12, dren o długości 210cm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu 27 poz. 13, 14, 15, 21, 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o dł. 210cm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu 27 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Pool CH 23 z rączką?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu 27 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści końcówkę z rączką Yankauer CH 12 z kontrolą odsysania?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu 27 poz. 32-35

Czy Zamawiający dopuści butelki Redona w opakowaniach foliowych?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu silikonowane?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14, Dotyczy Pakietu 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o rozmiarze rurki w czterech miejscach na łączniku, balonie oraz w dwóch miejscach na korpusie?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach, opakowanie typu tyvec?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści łączniki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17. Dotyczy Pakietu 29 pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści łączniki niesterylne?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18. Dotyczy Pakietu 29, pozycja 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z zadania 29 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19. Dotyczy Pakietu 31, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą o długości 4cm, opakowanie foliowe?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20. Dotyczy Pakietu 31, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą o długości 5,5cm w części przezroczystej oraz 6cm długości całkowitej?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21. Dotyczy Pakietu 31, pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z zadania 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 8_Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiołce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający

poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem.

Objętość wypełnienia całego zestawu 0,2ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 8. Poz. 2 i 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standard. Port dostępu zabezpieczony białym koreczkiem. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolece w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów, zatyczkę w kolorze białym. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,21 ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu 8. Poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządu do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiołki.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 22. Poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu 22.Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd w poz. 2 ma być wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym rozszczelnieniem i ekspozycją na leki niebezpieczne?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego – przezroczysta probówka 10 ml, naklejka i nakrętka umożliwiająca oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, zakończony końcówką schodkową, bez kontroli odsysania, dren o długości min. 10 cm

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 4



Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego składającego się z cewnika foley oraz systemu pomiaru ciśnienia składającego się z worka na mocz wraz z wyskalowanym drenem do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego

Odpowiedź.

Tak

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 9

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnej, dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 12

Czy zamawiający oczekuje sondy w rozmiarach 20-28?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 14

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma posiadać również nitkę biegnącą przez cewnik widoczną w RTG

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 15

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sondy dwunastniczej o długości roboczej 1210 mm, CH14-16, z 4 dużymi bocznymi otworami zapewniający właściwy drenaż. Rozmiar oczek porównywalny ze średnicą cewnika zapobiega blokadom. Anty-załamaniowa konstrukcja. Przejrzysty materiał umożliwia ocenę aspiratu. Zmrożona powierzchnia eliminuje potrzebę stosowania środków poślizgowych. Linia i koniec Rtg (Ryles) umożliwiają kontrolę wprowadzenia. Kodowane kolorem łączniki pasują do standardowych adapterów. Możliwość stosowania do 3 tygodni

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu 25.Poz. 17

Prosimy o dopuszczenie kanki odbytniczej o długości roboczej 36 cm w rozmiarach 18-24CH

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 6

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź.

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2. Dotyczy Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź.

Zamawiający wskazuje, że umowa w paragrafie 7 ust 1 lit e) przewiduje taką możliwość.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu 22. poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Nakładki na fiolkę 20 mm z balonem 50 ml. Adapter do fiołki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym, do fiołek o średnicy 20 mm, zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiołki do strzykawki, posiada igłę ze stali nierdzewnej, wdłużnie ściętą, system w połączeniu z Injectorem tworzy podwójną szczelnie przylegającą membranę, stanowiącą zamknięty system przenoszenia, gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 50 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu 22 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiołki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego w połączeniu z connectorem tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu 22, poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Krótki zestaw podłączeniowy (w przypadku podaży w systemie linii wielodrożnych) - Zestaw infuzyjny z wbudowanym łącznikiem do bezpiecznego przenoszenia leków do worków w systemie zamkniętym. Całkowita długość 41 cm. Wyposażony w nakładkę auto prime z hydrofobowym filtrem

wlotu powietrza do automatycznego napełniania posiadający dwa zaciski na linii zatrzaskowe. Nie zawiera PCV, DEHP

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 7

Pytanie 1. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. dotyczy SIWZ

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. dotyczy SIWZ

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5. dotyczy SIWZ

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i

jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Pakiet nr 24 pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu ran o długości 700 mm?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet nr 24 pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą z rozrywalną koszulką bez pojemnika do próbek?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet nr 24 pozycja 46

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Pakiet nr 27 pozycja 32, 34

Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania o pojemności 250 ml?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10 Pakiet nr 25 pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 Pakiet nr 25 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tylko cewniki Foley CH6-CH10 z prowadnicą pozostałe rozmiary bez prowadnicy?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Pakiet nr 25 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 Pakiet nr 25 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z tylną białą ścianą?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 Pakiet nr 31 pozycja 1-12, 17-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igieł pakowanych w opakowania po 100 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15 Pakiet nr 31 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml skalowanie co 0,5ml?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 Pakiet nr 31 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml skalowanie co 1ml?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 Pakiet nr 25 pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 Pakiet nr 25 pozycja 14, 15

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 Pakiet nr 25 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości (skalowana co 1 ml), uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej, komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną, nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik, elastyczny odporny na zagięcie dren łączący z zaciskiem i klamrą, paski boczne dla optymalnego umocowania, łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy, przelew bezpieczeństwa w urometrze (gdy urometr jest przepelniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru). Pojemnik na mocz o pojemności 2000 ml, zastawka antyrefluksyjna, czytelna podziałka w ml, nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik, zawór kranik spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu, szczelina do umocowania drenu spustowego?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20 Pakiet nr 25 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści worek do worka do lewatywy o poj. 1750ml, z dołączonym drenem, dren zakończony otworem centralnym i jednym otworem bocznym, oddalonym od końca dystalnego o min. 2 cm, z osłonką na końcówkę, zacisk, długość drenu 150 cm, niesterylny?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21 Pakiet nr 31 pozycja 22

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym firmom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 8

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 28.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w

piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH₂O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH₂O przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 9

Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy– Pakiet nr 26 poz.1.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 26 poz. 1 jednorazowego sterylnego zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Covidien Optistar Elite o następującym składzie:

2 x wkład do wstrzykiwacza kontrastu 60ml

1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. min. 150cm z trójnikiem Y i min. jednym zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości 375PSI

2 x złącze szybkiego napełnienia „J”

2 x ostrze typu Spike

Zestaw 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Covidien Optistar Elite.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 10

Pytanie 1.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy ujednolicenie zapisów dotyczących wymiany wadliwego towaru oraz wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, iż w § 4 pkt 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie : (.....)

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 5 dni przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu Wykonawcy Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

3. Wykonawca w ciągu 5 dni przypadających w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową.

Pytanie 2.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej zamówionej części przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej, zamówionej części przedmiotu umowy**

b) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części umowy** określonego w § 3 ust. 3 - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3.

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 11**Pytanie 1. Dotyczy pakietu 31. Poz.21**

Czy Zamawiający w Grupie 31 poz. 21 dopuści wycenę strzykawki skalowanej co 1 ml?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu 31. Poz.25

Czy Zamawiający w Grupie 31 poz. 25 dopuści strzykawki typu MARGOMED 50ml, powszechnie stosowanej w szpitalach?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

W związku ze wzmożoną ilością postępowań przetargowych oraz okresem urlopowym proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15 stycznia 2021r. lub późniejszy.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień: 21.01.2021r do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2021 o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych pokój 213 , w siedzibie Zamawiającego

Zestaw pytań nr 12**Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 17-20,22-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z rozszerzona skala?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 17-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeliczenia strzykawek pakowanych po 50 lub po 80 sztuk

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 13**Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny posiadający przestrzeń martwą 35 ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z portem zamykanym zatyczką przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 14

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aplikator typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 0,2 µm oraz cząsteczkowym 5 µm posiadający nieruchomą osłonę, szczelnie otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu 8 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści aplikator typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 45 µm oraz cząsteczkowym 5 µm posiadający nieruchomą osłonę, szczelnie otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 Dotyczy Pakietu 9, 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty bezigłowy łącznik, wielofunkcyjny, o małym rozmiarze, umożliwiającym pobieranie próbek, wstrzykiwanie lub stosowanie infuzji płynów, leków. Całkowicie przezroczysta obudowa ułatwiająca obserwację przepływających płynów. Łatwa do dezynfekcji membrana silikonowa (dezynfekcja musi być przeprowadzona przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone. Posiada prosty tor przepływu. Zapobiega cofaniu się krwi po odłączeniu strzykawki lub linii. Odporny na tłuszczowe emulsje, cytotoksyczne leki oraz na antyseptyki. Łatwe do użycia urządzenie chroni personel medyczny i pacjenta (zamknięty system redukuje ryzyko zatoru powietrznego oraz utraty krwi). Służy do podłączenia do urządzeń (strzykawkami, drenami przedłużającymi, itp.) posiadających męską końcówkę Luer-Lock, której średnica jest $\geq 1,7\text{mm}$ (większość urządzeń) oraz do wszystkich urządzeń z żeńską końcówką Luer. Objętość wypełnienia (przestrzeń martwa) 0,07 ml. Wypływ wsteczny 0,03 ml. Przepływ nielimitowany do 600 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie do 24 barów. Może być używany w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej. Okres użytkowania gwarantowany przez producenta wynosi 7 dni lub 360 użyci (720 aktywacji). Pakowany pojedynczo, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawiera części metalowych, nie zawiera Lateksu, nie zawiera ftalanów, nie zawiera pirogenów?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dot. Pakiet nr 4 celem dołączenia do oferty.

4 Dostawa drutu do pętli do polipów dla Oddziału Laryngologii "

lp	Nazwa artykułu	j.m.	zamawia ilość
1	Drut do pętli do polipów o dł 10cm , średnica 0,3mm	szt	1000

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych
Zagł... Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Św. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Kocot

